



Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

predstojnik KIKKB: prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem.

Njegoševa 4

1525 Ljubljana

T 01/522 2437

F 01/4325131

E [tajnistvo.kikkb@kclj.si](mailto:tajnistvo.kikkb@kclj.si)

W [www.kclj.si](http://www.kclj.si)

Št.: 467/2022

Ljubljana, 4.7.2022

PREDSTOJNIKOM IN GLAVNIM SESTRAM KLINIČNIH ODDELKOV UKCL IN ZUNANJIM NAROČNIKOM

**ZADEVA: Obvestilo naročnikom o pravilnem nameščanju nalepk s črtnimi kodami na epruvete**

Spoštovani,


zaradi prehoda na novo tehnologijo vas prosimo, da na epruvete pravilno nameščate nalepke s črtnimi kodami (slika 1). Nalepka mora biti:

- obrnjena tako, da je koda obrnjena pokončno, s prvo črko priimka obrnjeno navzgor,
- nalepljena vsaj 1 centimeter pod robom zamaška in
- nalepljena naravnost.

Na nalepki mora biti nalepka s pravilno oznako barve zamaška (prva črka kratice označuje barvo zamaška):


- RS – epruveta z rdečim ali rumenim zamaškom
- ZP – epruveta z zelenim zamaškom
- SP – epruveta s sivim zamaškom
- U – urinska epruveta z rumenim zamaškom
- 

Slika 1: Primeri pravilno nameščenih nalepk s črtnimi kodami.

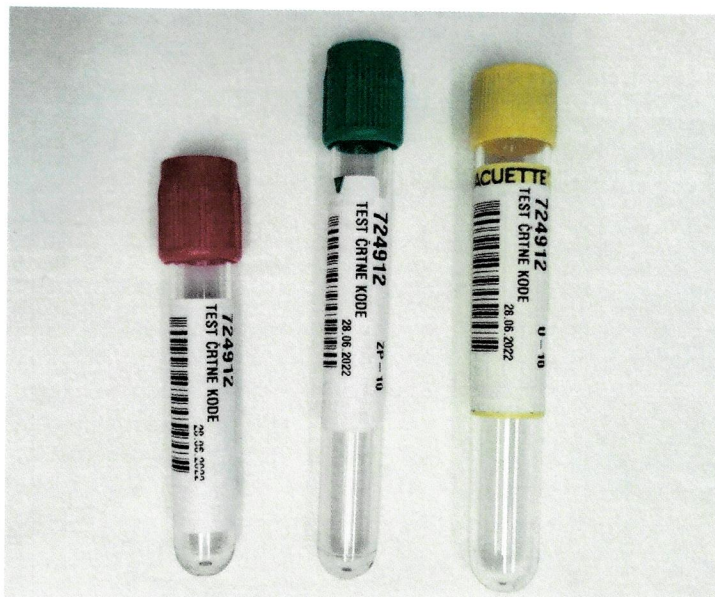

Nepravilno nameščanje nalepk s črtnimi kodami (slika 2) bo povzročilo podaljšane čase do izdaje izvidov.

Slika 2: Primeri nepravilno nameščenih nalepk s črtnimi kodami

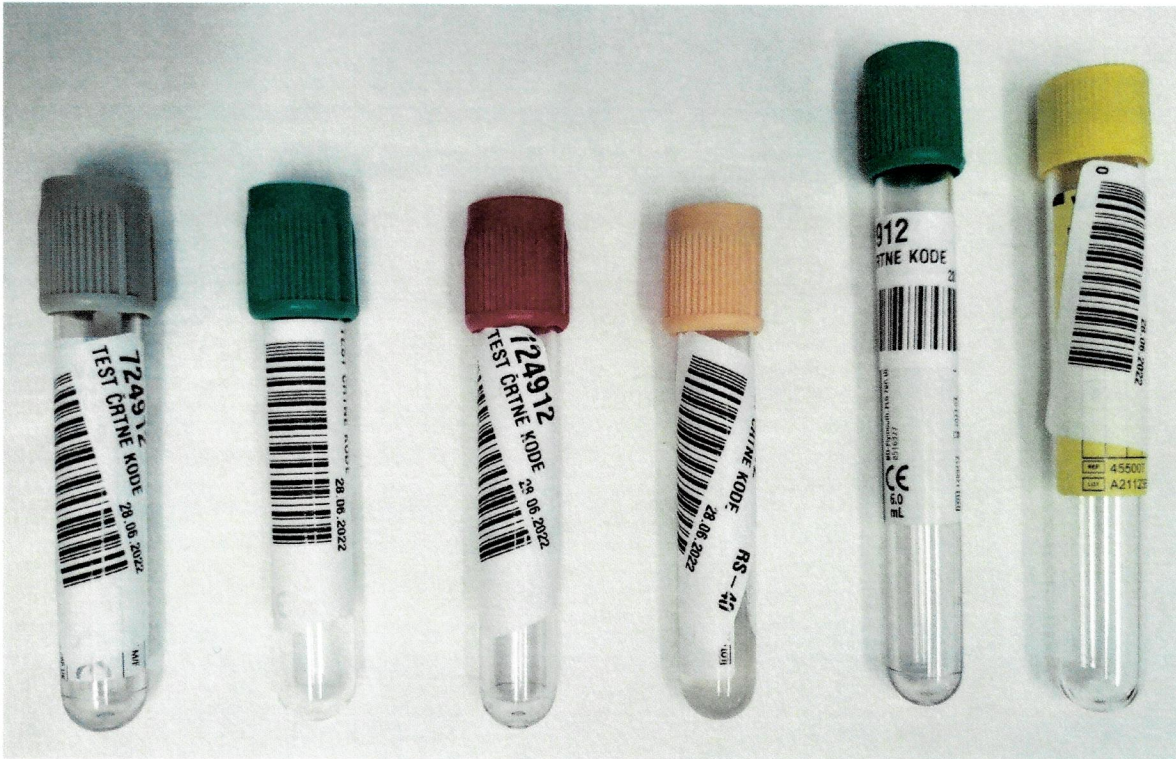

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav,

prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem.  
predstojnik KIKKB

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA  
Klinični inštitut  
za klinično kemijo in biokemijo  
Ljubljana, Njegoševa cesta 4 3